

Intramedullary nail for the radius

Patent Number: EP1095626

Publication date: 2001-05-02

Inventor(s): GNOS ROBERT (CH); GUELMI DR KAMEL (FR)

Applicant(s): SULZER ORTHOPEDICS LTD (CH)

Requested Patent: EP1095626

Application Number: EP20000810915 20001004

Priority Number(s): EP20000810915 20001004; EP19990810989 19991101

IPC Classification: A61B17/72

EC Classification: A61B17/72

Equivalents:

Cited Documents: DE9115201U; WO9935989; EP0202141

Abstract

The nail has a curvature along its lengthwise axis, and has a fixture head (2). A sloping transverse hole (3) intersects the lengthwise axis(1) at a distance of less than 30 millimeters from the end of the fixture head. The fixture head has a greater diameter than the rest of the nail (10).

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 1 095 626 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
02.05.2001 Patentblatt 2001/18

(51) Int Cl.7: **A61B 17/72**

(21) Anmeldenummer: 00810915.9

(22) Anmeldetag: 04.10.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder:
• **Gnos, Robert**
8932 Mettmenstetten (CH)
• **Guelmi Dr. Kamel,**
Chirurgien des Hôpitaux de Paris
75730 Paris Cedex 15 (FR)

(30) Priorität: 01.11.1999 EP 99810989


(71) Anmelder: **Sulzer Orthopedics Ltd.**
6340 Baar (CH)

(74) Vertreter: **Sulzer Management AG**
KS/Patente/0007
Zürcherstrasse 12
8401 Winterthur (CH)

(54) Radiusmarknagel

(57) Mit der Erfindung ist ein Marknagel (10) für den distalen Bereich eines Radiusknochens (20) gezeigt. Der Marknagel (1) besitzt einen Krümmungsradius R zwischen 100 und 1000 mm, damit er neben den distalen Gelenkflächen (23, 24) des Radiusknochens einbringbar ist, und eine schräggestellte Querbohrung (3), die den Marknagel (1) in einer Distanz von weniger als 30 mm vor seinem Ende kreuzt, um auch Knochenstücke von Brüchen, die quer durch die distalen Lagerflächen verlaufen, zu fassen. Das Ende des Marknagels ist als Befestigungskopf (2) für eine Zielvorrichtung für Querbohrungen (3) ausgebildet.

Fig.1

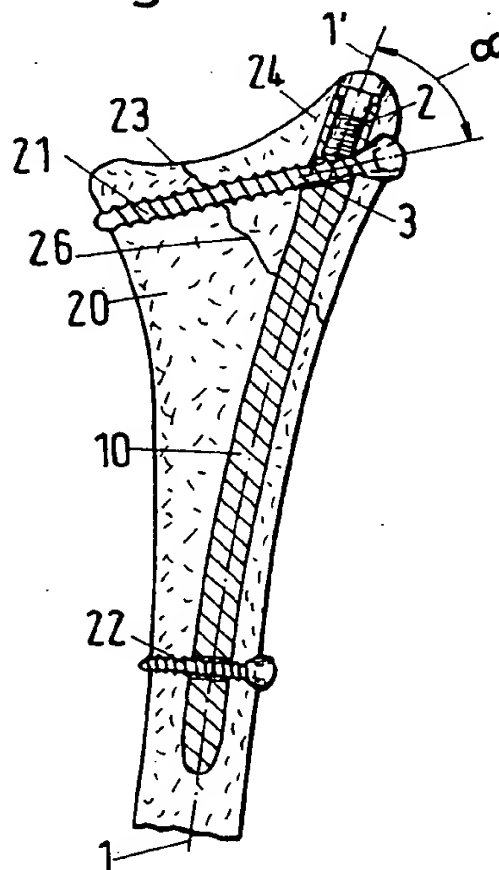

EP 1 095 626 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung handelt von einem Radiusmarknagel, den es bisher in der vorgeschlagenen Form nicht gab.

[0002] Knochenbrüche in der Nähe des Handgelenks treten relativ häufig auf. Gerade bei älteren Menschen wird das Gefühl für das Gleichgewicht schlechter, die Hände werden mehr zur Abstützung benutzt und gleichzeitig tritt eine Schwächung der Knochen ein. Die Folge sind Brüche am Radiusknochen in der Nähe der Artikulationsflächen zum Handgelenk, d.h. zum Scapahoid und zum Lunatum. Diese Brüche treten als Scherung unterhalb der Gelenkflächen auf oder gehen quer durch die Gelenkflächen. Die bisherigen Behandlungsmethoden bestanden im Anbringen von Knochenplatten und/oder Knochenschrauben oder aber im Anbringen von einem Gipsverband mit dem Risiko, dass die Knochenfragmente nicht gerade in einer optimalen Stellung zusammenwachsen.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es eine sichere Schienung für Brüche des Radiusknochens in der Nähe vom Handgelenk zu schaffen. Diese Aufgabe wird gelöst durch einen Radiusmarknagel mit einer Krümmung seiner Längsachse entsprechend einem mittleren Krümmungsradius $100 < R < 1\,000$ mm, mit einem Befestigungskopf für eine Zielvorrichtung und mit einer schräggestellten Querbohrung, die in einer Distanz von weniger als 30 mm vom Ende des Befestigungskopfes entfernt, die Längsachse kreuzt.

[0004] Der Vorteil dieses Marknagels liegt darin, dass er ausserhalb der Gelenkfläche für den Scapahoid am Processus styloideus einbringbar ist und unmittelbar unterhalb der Gelenkflächen im Bereich der grössten Querausdehnung das Einbringen einer Knochenschraube zur Fixation und Sicherung erlaubt. Dabei dient der im Radiusknochen verankerte Marknagel, als Referenz für zu befestigende Knochenbruchstücke. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass durch die Schienung von innen nur kleine äussere Verletzungen für den Eintritt von Marknagel und für Sicherungsschrauben angebracht werden müssen.

[0005] Die abhängigen Patentansprüche 2 bis 10 stellen vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung dar. So ist es vorteilhaft, verschieden lange Radiusmarknägel mit Längen von 50 bis 200 mm und mit verschiedenen Durchmessern von 3 bis 10 mm vorzusehen, um das Spektrum von unterschiedlichen Patienten abzudecken. Um den Befestigungskopf für die Befestigung einer Einschlag- und Zielvorrichtung und für das Anbringen der schräggestellten Querbohrung nicht unnötig zu schwächen, wird er mit einem grösseren Aussendurchmesser als der Rest des Radiusmarknagels versehen. Die Querbohrung kann mit der Schaftachse des Befestigungskopfes einen Winkel α zwischen 40° und 70° bilden, um mit der Querbohrung einen Bereich nahe unterhalb der Gelenkpfannen im distalen Bereich des Radiusknochens zu kreuzen und um auch Knochenbruch-

stücke von Brüchen durch die Gelenkpfannen zu fassen. Mit einem Winkel α zwischen 55° und 65° kann die Querbohrung soweit gegen distal verschoben werden, dass ihre Längsachse den Befestigungskopf in einer Distanz von weniger als 15 mm vor seinem Ende kreuzt. Eine weitere Querbohrung ist zur Verankerung des Radiusmarknagels in seiner Spitze vorgesehen. Als Werkstoff für den Radiusmarknagel sind körpverträgliche Metalle, zum Beispiel Chrom-Kobalt-Nickel-Legierungen nach ISO 5832-1 oder Titanlegierungen geeignet. Zum Einbringen des Marknagels wird zunächst mit einem Pfriem, dessen vorderer Bereich bezüglich Aussendurchmesser und Krümmung seiner Längsachse dem Radiusmarknagel entspricht, in der Nähe des Processus styloideus angesetzt, um den Marknagel in Form einer langgestreckten Krümmung zu eröffnen. Dies hat den Vorteil, dass die eigentlichen Gelenkflächen zu Scapahoid und zu Lunatum unberührt bleiben. Anschliessend kann der Radiusmarknagel an seinem Befestigungskopf mit einem Gleithammer in den Radiusknochen eingetrieben werden. Zur Befestigung des Gleithammers kann das gleiche Gewinde im Befestigungskopf wie für einen nachfolgend aufgesetzten Zielbügel verwendet werden. Zwischen Zielbügel und Befestigungskopf besteht zusätzlich eine formschlüssige Kopplung, die sicherstellt, dass Querbohrungen des Radiusmarknagels und zugehörige Zielbohrungen im Zielbügel miteinander fluchten. Zielvorrichtung und Gleithammer können auch miteinander kombiniert sein.

[0006] Da die Querbohrungen im Radiusmarknagel nur einen Durchmesser von wenigen Millimetern haben können, ist es vorteilhaft, den Abstand zwischen Zielbügel und Querbohrung mit einer biegesteifen Bohrbüchse zu überbrücken. Gleichzeitig erhält ein Bohrer auf diese Weise eine wesentlich längere und genauere Führung, die mehr als das achtfache des Bohrerdurchmessers betragen kann. Die Bohrbüchsen sind abnehmbar, damit sie die Befestigung des Zielbügels nicht hindern und nach dessen Befestigung soweit vorgetrieben werden können, dass sie mit ihrer geschärften Vorderkante eine Abstützung im Radiusknochen erhalten.

[0007] Im folgenden wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen beschrieben. Es zeigen:

- 45 Fig. 1 Schematisch einen Längsschnitt durch einen in einem Radiusknochen eingesetzten Marknagel;
- 50 Fig. 2 Schematisch den Radiusmarknagel von Figur 1 in einer Seitenansicht auf die Ebene, in der die Krümmung seiner Längsachse liegt;
- 55 Fig. 3 Schematisch eine vergrösserte, um 90° gedrehte Seitenansicht des Befestigungskopfes von Figur 2; und
- Fig. 4 Schematisch eine Seitenansicht eines Radiusmarknagels analog zu Figur 2 mit einer am

Radiusmarknagel befestigten Zielvorrichtung.

[0008] Mit den Figuren ist ein Marknagel für den distalen Bereich eines Radiusknochens gezeigt. Der Marknagel besitzt einen Krümmungsradius R zwischen 100 und 1000 mm, damit er neben den distalen Gelenkflächen des Radiusknochens einbringbar ist, und eine schräggestellte Querbohrung, die den Marknagel in einer Distanz von weniger als 30 mm vor seinem Ende kreuzt, um auch Knochenstücke von Brüchen, die quer durch die distalen Lagerflächen verlaufen, zu fassen. Das Ende des Marknagels ist als Befestigungskopf für eine Zielvorrichtung für Querbohrungen ausgebildet.

[0009] Die Hinweiszeichen sind in den Figuren gleich verwendet.

In Figur 1 erstreckt sich ein Marknagel 10 in einen Radiusknochen 20 von dessen distalen Ende her und überbrückt eine Bruchstelle 26. Die Eintrittsöffnung für den Marknagel 20 ist ausserhalb der Gelenkpfannen 23, 24 für angrenzende Handgelenkknochen Lunatum und Scapahoid am Processus styloideus gewählt. An der Spitze des Marknagels 10 ist eine Knochenschraube 22 quer eingebracht, um die Spitze im Radiusknochen 20 zu sichern. Der Marknagel 20 selbst ist in der Zeichenebene gekrümmt und an seinem gegen aussen gerichteten Ende mit einem Befestigungskopf 2 versehen, der eine gerade Längsachse 1' als Fortsetzung der Längsachse 1 des gekrümmten Bereiches aufweist. Eine zweite Querbohrung 3, welche in einem spitzen Winkel α die Längsachse 1' des Befestigungskopfes 2 kreuzt, ermöglicht es, den Marknagel auf der Eintrittsseite mit einer weiteren Knochenschraube 21 zu verankern und bei Brüchen, die durch die Lagerschalen 23, 24 gehen, die Bruchstücke zusätzlich zueinander zu fixieren.

[0010] Der Marknagel 10, wie er in Figur 2 und 3 dargestellt ist, besitzt eine ungestreckte Länge L von 100 mm und einen Krümmungsradius R von 350 mm. Der Durchmesser 6 des gekrümmten Bereiches beträgt 5 mm und der Durchmesser des Befestigungskopfes 7 beträgt 6 mm. Die schräggestellte Querbohrung 3 kreuzt den Befestigungskopf 2 in einem Abstand 4 von 12 mm von seinem äusseren Ende 5 in einem spitzen Winkel α von 59° . Die Querbohrung 3 selbst hat einen Durchmesser von 4 mm, während die Querbohrung 8 an der Spitze des Marknagels 10 einen Durchmesser von 2,7 mm besitzt. Das äussere Ende 5 ist als Auflagefläche ausgebildet, die durch eine Nut 25 unterbrochen ist, um eine Zielvorrichtung 9 bezüglich Drehung um die Längsachse 1' auszurichten. Auf der Innenseite ist eine zylindrische Bohrung 28 in Längsrichtung mit einem Gewinde 27 versehen, um die Zielvorrichtung 9 oder einen Gleithammer zu verankern. Im vorliegenden Beispiel wird ein Gleithammer, der einen vorstehenden Gewindezapfen aufweist, am Gewinde 27 des Befestigungskopfes angeschraubt und der Marknagel vorsichtig eingeschlagen.

[0011] In Figur 4 ist ein Radiusmarknagel 10 mit sei-

ner Zielvorrichtung 9 gekoppelt. Die Befestigung wird an einem Ansetzstück 16 mit einer Befestigungsschraube 12 vorgenommen, die mit ihrem Kopf 13 die Zielvorrichtung 9 hält und die Zielvorrichtung in einer vorgesehenen Position starr an den Marknagel koppelt. Die eigentliche Zielvorrichtung bildet einen U-förmigen Bügel 9 mit seitlich wegstehendem Griff 19. Fluchtend mit den Querbohrungen 3, 8 des Marknagels sind relativ grössere Führungsbohrungen 17 im Zielbügel 9 angebracht, in welche längsverschiebbliche Bohrbüchsen 14 eingesetzt sind. Die Bohrbüchsen 14 verjüngen sich an ihrer Spitze zu einer dünnen, zugeschärften Hülse, die bis unmittelbar an den Marknagel 10 heranreicht und sich mit ihrer ringförmigen Schneide am Radiusknochen abstützen kann. Die relativ dünnen Bohrer 15, welche mit den Querbohrungen 3, 8 fluchtend auf einem Durchmesser von Zielbohrungen 11 die Knochenrinde vorbohren, sind bis unmittelbar an den Knochen geführt und können nicht aus der vorgesehenen Richtung verlaufen. Eine solche Führung ist bei einer zur Knochenwand schräg angeordneten Bohrung 3 besonders wichtig. Nach dem Vorbohren können die Bohrbüchsen 14 jeweils herausgezogen werden und durch die grösseren Führungsbohrungen 17 jeweils die passenden Knochenschrauben 22, 21 angesetzt und eingedreht werden. Die Bohrbüchsen 14 besitzen jeweils einen Haltekopf 18, der die Zustellung in Längsrichtung begrenzt und ihr Herausziehen ermöglicht.

[0012] Grundsätzlich ist es auch möglich, die Zielvorrichtung mit einem Gleithammer zu kombinieren, indem beispielsweise der Kopf 13 der Befestigungsschraube 12 soweit nach oben verlängert ist, dass ein Innengewinde für den Gewindezapfen eines Gleithammers Platz hat. Wegen der relativ geringen Abmessungen des Marknagels muss dann darauf geachtet werden, dass die Zentrierflächen zwischen Ansetzstück 16 und Befestigungskopf 2 durch das Einschlagen nicht beschädigt werden.

Patentansprüche

1. Radiusmarknagel mit einer Krümmung seiner Längsachse (1) entsprechend einem mittleren Krümmungsradius $100 < R < 1\,000$ mm, mit einem Befestigungskopf (2) für eine Zielvorrichtung (9) und mit einer schräggestellten Querbohrung (3), die in einer Distanz (4) von weniger als 30 mm vom Ende (5) des Befestigungskopfes (2) entfernt, die Längsachse (1) kreuzt.
2. Radiusmarknagel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass er als Aussenabmessungen eine Länge L von 50 mm bis 200 mm und Durchmesser (6, 7) innerhalb eines Bereiches von 3 mm bis 10 mm aufweist.
3. Radiusmarknagel nach einem der Ansprüche 1

oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Befestigungskopf (2) einen grösseren Durchmesser (7) als der restliche Nagel (10) aufweist.

4. Radiusmarknagel nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die schräggestellte Querbohrung (3) mit der Schaftachse (1') des Befestigungskopfes (2) einen Winkel α zwischen 40° und 70° bildet. 5
5. Radiusmarknagel nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Winkel α zwischen 55° und 65° liegt und dass die schräggestellte Querbohrung (3) die Längsachse (1) in einer Distanz (4) von weniger als 15 mm vom Ende (5) des Befestigungskopfes (4) kreuzt. 10 15
6. Radiusmarknagel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass er in der Nähe seiner Spitze eine weitere Querbohrung (8) aufweist. 20
7. Radiusmarknagel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass er aus einer Chrom-Kobalt-Nickel-Legierung beispielsweise aus einem Werkstoff nach ISO 5832-1 oder aus einer Titanlegierung hergestellt ist. 25
8. Zielvorrichtung für einen Radiusmarknagel (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass sie in einer vorgegebenen Position am Befestigungskopf (2) des Radiusmarknagels (10) befestigbar ist und dass sie in dieser Position auf der Seite des Marknagels, auf welcher auch der Mittelpunkt für den Krümmungsradius R liegt, einen Bügel (9) mit Zielbohrungen (11) für die Querbohrungen (3, 8) am Radiusmarknagel (10) aufweist. 30 35
9. Zielvorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Zielbügel (9) mit einer Befestigungsschraube (12) am Befestigungskopf (2) verankerbar ist, welche gleichzeitig einen zur Schlagübertragung ausgebildeten Schraubenkopf (13) aufweist. 40 45
10. Ziel und Einschlagvorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass Führungsbohrungen (17) im Zielbügel (9) mit wesentlich grösseren Durchmessern als die Querbohrungen (3, 8) des Radiusmarknagels (10) angebracht sind, und dass Bohrbüchsen (14) in die Führungsbohrungen (17) einsetzbar sind, welche einen Bohrer (15) über eine Länge von mehr als dem achtfachen des Bohrerdurchmessers führen. 50 55



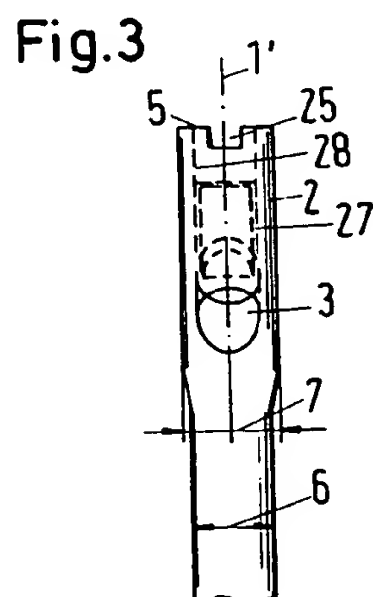


Fig.4

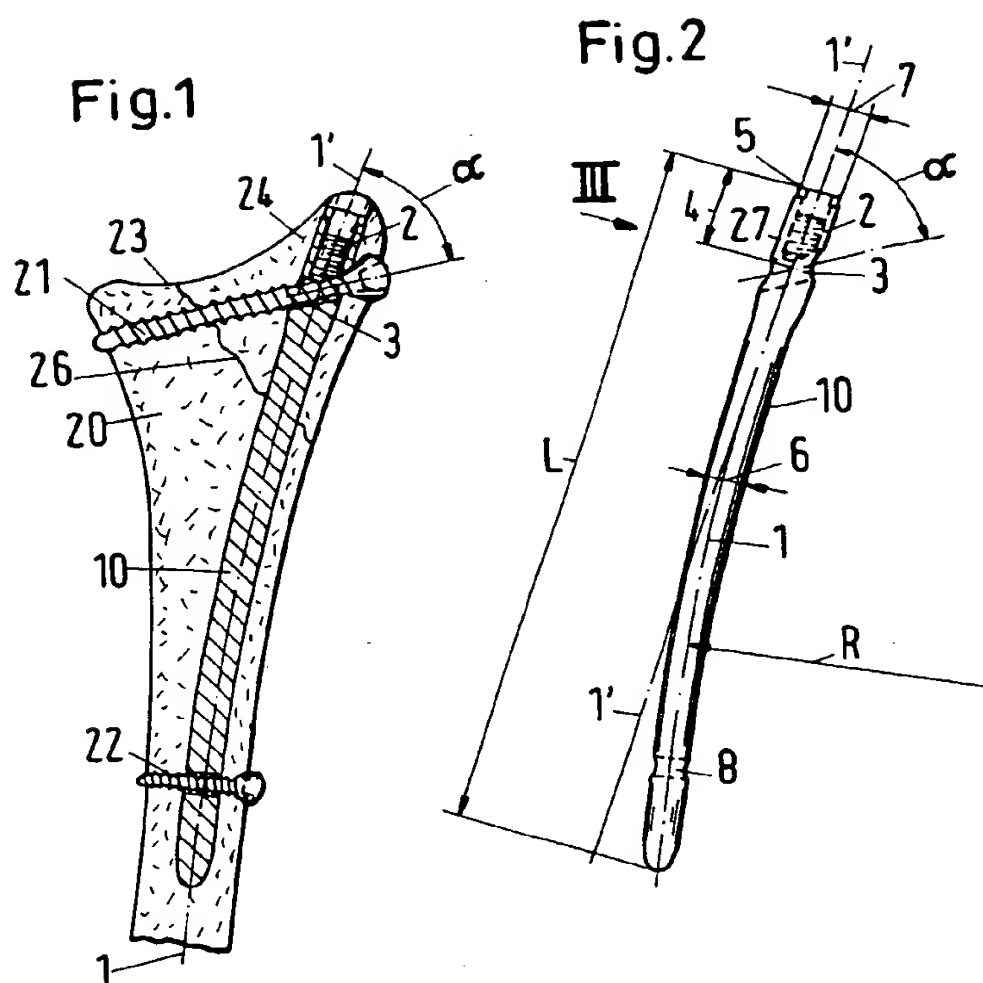

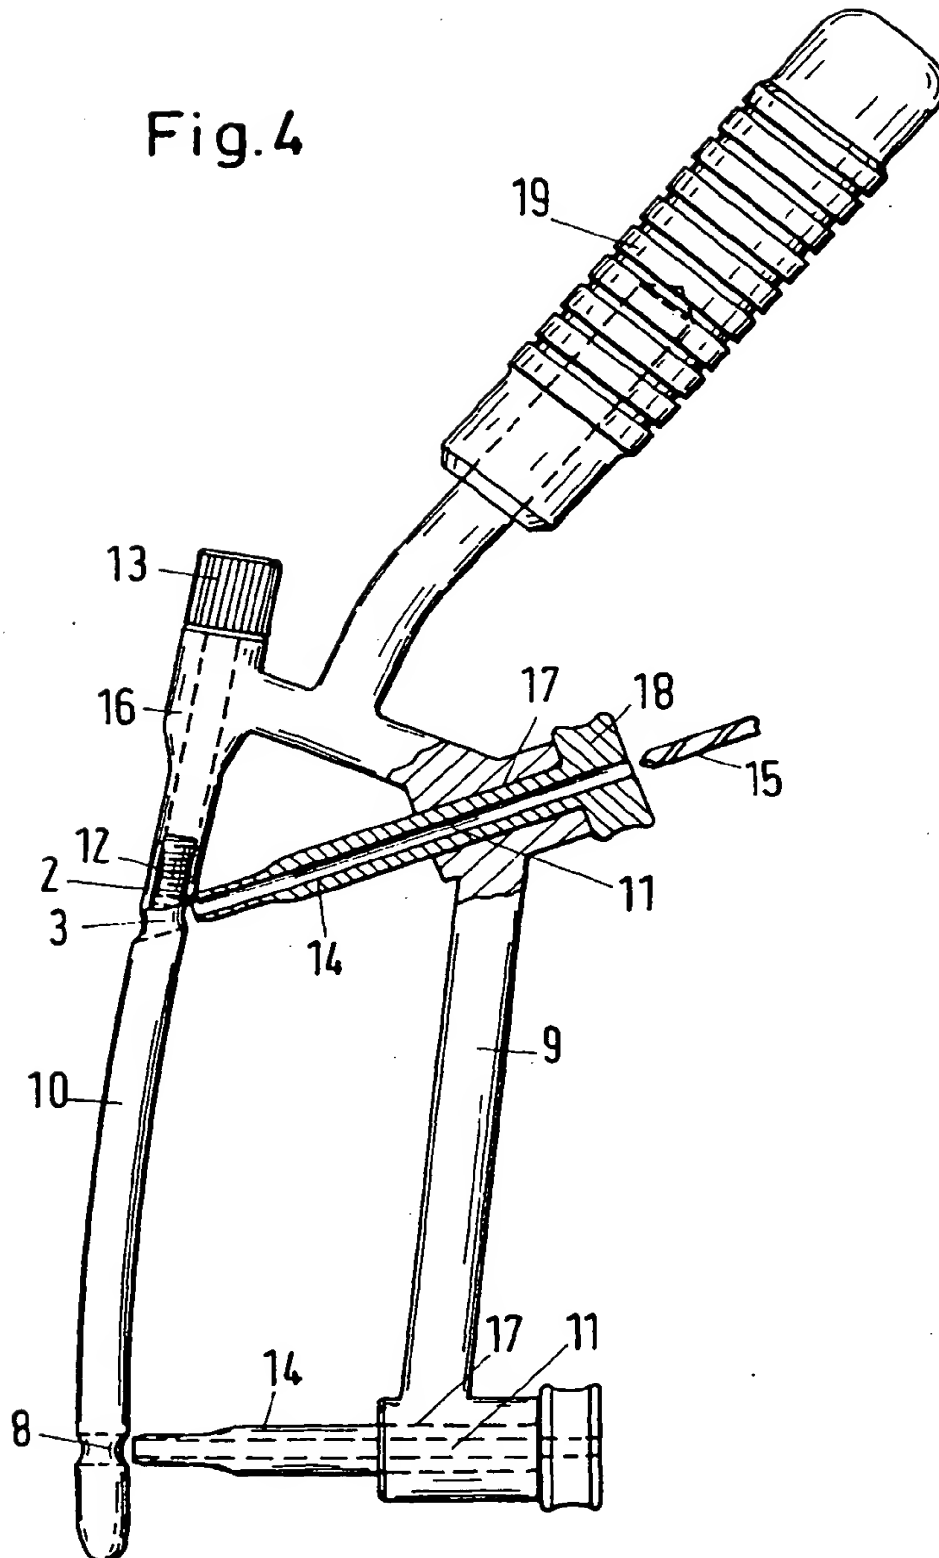

Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 00 81 0915

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
Y	DE 91 15 201 U (HOWMEDICA) 6. Februar 1992 (1992-02-06) * Anspruch 1; Abbildung 1 * * Seite 3, Zeile 4 - Zeile 5 * * Seite 4, Zeile 3 - Zeile 12 * * Seite 5, Zeile 18 - Zeile 20 * * Seite 10, Zeile 9 - Zeile 14 * * Seite 10, Zeile 20 - Seite 11, Zeile 3 * ----	1-10	A61B17/72
Y	WO 99 35989 A (H.HABERNEK UND C.HERZA) 22. Juli 1999 (1999-07-22) * Seite 1, Zeile 22 - Zeile 35 * * Abbildungen 1,2 * ----	1-10	
A	EP 0 202 141 A (META CERAM UND LA BIOMECHANIQUE INTEGREE) 20. November 1986 (1986-11-20) * Spalte 1, Zeile 15 - Zeile 18 * -----	7	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			A61B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	
DEN HAAG		8. Februar 2001	
		Prüfer	
		Nice, P	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: nichtschrittliche Offenbarung P: Zwischenliteratur		T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument ----- & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1303 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 00 81 0915

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Daten des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

08-02-2001

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 9115201 U	06-02-1992	AT 157234 T	15-09-1997
		CA 2084601 A,C	08-06-1993
		DE 69221838 D	02-10-1997
		DE 69221838 T	12-02-1998
		DK 547380 T	06-04-1998
		EP 0547380 A	23-06-1993
		ES 2108068 T	16-12-1997
		GR 3025417 T	27-02-1998
		JP 2549805 B	30-10-1996
		JP 5237136 A	17-09-1993
		US 5397328 A	14-03-1995
WO 9935989 A	22-07-1999	AU 1864199 A	02-08-1999
		DE 29980004 U	21-12-2000
EP 0202141 A	20-11-1986	FR 2580170 A	17-10-1986
		DE 3679863 D	25-07-1991

EPO FORM P0481

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr. 12/82